





## AUTOMATISIERTE HBA1C-BESTIMMUNG IN LABORQUALITÄT



### HbA<sub>1c</sub> Testdurchführung

Sie tragen nur das Blut auf - den Rest erledigt der Wellion CLEVER Analyzer

#### Test starten




Führen Sie einen Teststreifen ein.

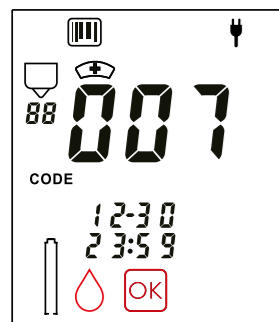


Wenn das Blutstropfen-Symbol und das OK-Tasten-Symbol auf dem Bildschirm blinken, tragen Sie die Blutprobe auf den Probennehmer auf bis der Faden durchgehend rot getränkt ist.

#### Blutprobe auftragen




Nachdem die Blutprobe fertig aufgetragen ist, drücken Sie die OK-Taste, um einen Test zu starten. Danach startet ein 10 Sekunden Countdown, während dem der Puffer A automatisch aufgetragen wird.




Nach dem 10 Sekunden Countdown blinkt das Probennehmer Symbol am Display (eine Sprachaufforderung erfolgt). Jetzt halten Sie den Probennehmer für 3 Sekunden auf den Probennehmer-Kontakt.

Nach dem Auftragen der Blutprobe folgen zwei Runden von Countdowns, führen Sie währenddessen keine Eingriffe am Analyzer durch.

#### Das Ergebnis ablesen

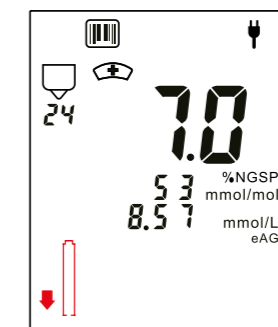

Notieren oder drucken Sie das Testergebnis und entsorgen Sie alle Verbrauchsmaterialien (z.B. gebrauchte Teststreifen) in geeigneten Containern. Entsprechend den gültigen Laborvorschriften und örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.



Verschließen Sie das Puffer Kit mit der Verschlusskappe, wenn Sie keine weiteren Tests durchführen.

1  
**130 Sek**

2  
**130 Sek**